

เลขที่ 24-55

คุณลักษณะเฉพาะ รพ.ตต. อనุมติ ลงวันที่ 1 พ.ศ.2555

เตียงนอนผู้ป่วยกระดูกชนิดปรับตัวยระบบไฟฟ้า1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยทั่วไปแบบปรับท่าทางด้วยระบบไฟฟ้าและระบบเบตเตอร์สำรองไฟฟ้า

2. ลักษณะทั่วไป

2.1 โครงสร้างเตียง ทำด้วยโลหะอบพ่นสีกันสนิม ทนต่อแรงกระแทกสูงขึ้นชิดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อได้ และรากน้ำเตียงทำด้วยวัสดุพลาสติก ABS แบบนิ่มชี้นรูป

2.2 ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเพื่อปรับจัดท่าต่างๆ โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการควบคุมการทำงาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน IEC60601 และ CB Test Certificate

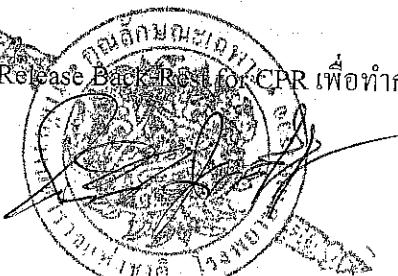
2.3 มีที่ติดตั้งเสาแขวนน้ำเกลือได้ไม่น้อยกว่า 4 จุด

2.4 มีกล่องครอบมอเตอร์ เป็นวัสดุชนิดทนการกระแทกและสามารถป้องกันน้ำได้เข้ามอเตอร์ได้ง่าย พื้นเตียงแบ่งไม่น้อยกว่า 4 ตอน มีช่องระบายน้ำอากาศทำด้วยแผ่นโลหะ

2.5 ใช้ไฟฟ้ากระแสต้น 220 – 240 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ และมีระบบการทำงานสำรองเมื่อไฟฟ้าดับเป็นระบบเบตเตอร์สำรองไฟฟ้า

2.6 มีระบบในการปรับรูปแบบเตียงเร่งด่วนแบบ Quick Release Backrest CPR เพื่อทำการกระตุนหัวใจหรือ CPR

พ.ศ.๒๕๕๕

3. คุณลักษณะทางวิชาการ

3.1 ขนาดเตียงกว้าง กว้างขวาง ไม่น้อยกว่า 110x200 เซนติเมตร และเตียงสามารถปรับได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 65 เซนติเมตร สามารถปรับระดับได้ต่ำสุด ไม่เกิน 50 เซนติเมตร โดยวัดจากพื้นห้องถึงพื้นเตียง ขนาดของล้อมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว หรือ 15 เซนติเมตร สือท่าจากวัสดุยาง โดยแกนกลางเป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์

3.2 ระบบรากน้ำเตียง (Siderails) สูง ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตรจากพื้นเตียง แบ่งเป็น 2 ส่วน ศีรษะและลำตัวห่างกัน ไม่เกิน 10 เซนติเมตร เพื่อป้องกันคนไข้ตกเตียง และมี 2 ขนาด คือ ส่วนศีรษะมีความยาวไม่น้อยกว่า 57 เซนติเมตร และส่วนลำตัวมีความยาวไม่น้อยกว่า 107 เซนติเมตร รากน้ำมีความนิ่นคงทนทานแข็งแรง และเก็บอยู่ข้างเตียง ทำด้วยพลาสติกนิ่มชี้นรูป โดยขาของรากน้ำหักเหล็กเพื่อความแข็งแรงและมีโช๊คอัพ (Shock Absorber) แก้สเพื่อป้องกันการกระแทกขณะยกลง

พ.ต.อ. หญิง..... ผู้อำนวยการ กรรมการ
(สุวรรณ จาธุสุกสรร)

พ.ต.อ. หญิง..... ผู้อำนวยการ กรรมการ
(สุชาดา คำเขียว)

พ.ต.อ. หญิง..... ผู้อำนวยการ กรรมการ
(วิรกรอง รัตนสุวรรณ)

เดือนที่ ๒๕๖๕

เลข. ๑๗๓, ถนนมหิดล ลงวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๕

3.3 สามารถปรับท่าตัวผู้ป่วยได้ด้วยอุปกรณ์ควบคุมชนิด Remote Control โดยสามารถปรับท่าต่างๆ ได้ดังนี้

3.3.1 ปรับท่ายกกระดับหลัง (ศรีษะ) (Head Articulation) ขึ้น ได้ไม่น้อยกว่า 75 องศา

3.3.2 ปรับท่ายกกระดับข้อเข่า (Knee Articulation) ขึ้น ได้ไม่น้อยกว่า 40 องศา

3.3.3 ปรับระดับความสูง – ต่ำของเตียงทึ่งเตียง ได้ในช่วงระหว่าง 50 – 65 เซนติเมตร หรือกว่า

3.4 เตียงรับน้ำหนักสูงสุดได้มากกว่า 230 กิโลกรัม

3.5 ระบบเบรกเป็นแบบระบบเบรกกลาง (Central Lock) สามารถเบรกได้จากตำแหน่งเดียวที่ปลายเตียง โดยเป็นแบบคานเหยียบให้สะดอกต่อการใช้งาน เพื่อถือค้างทึ่ง 4 ถือโดยไม่จำเป็นต้องปรับถือให้บนกันเตียง

3.6 มีพนักพิงหัวเตียงเป็นเหล็กรูปสี่เหลี่ยมขอบโค้งมน สามารถรองรับแทร็คชั้นบาร์ที่มีอยู่เดิมของโรงพยาบาลได้ ขนาดกว้าง(สูง)xยาว(วัดซ้ายไปขวา) ไม่น้อยกว่า 50x90 เซนติเมตร

3.7 มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว (Leakage)

4. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ

4.1 เบาะที่นอนเป็นแบบ 4 ตอน ตามสิริร่องของเตียงและร่างกาย มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ภายในทำด้วยฟองน้ำและไน靡พร้าวอย่างดี จำนวน 1 หลัง และมีหมอนหนุนชนิดไขสังเคราะห์จำนวน 1 ใบ

4.2 ที่นอนหุ้มด้วยวัสดุสั้งเคราะห์ที่กันน้ำ และการซึมเปื้อนจากภายนอกสามารถทำความสะอาด และเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้

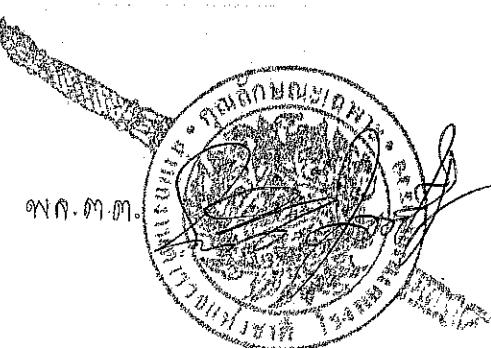
4.3 เสาสำหรับรับแขวนน้ำเกลือทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) แบบเก็บได้ จำนวน 2 อัน

4.4 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาภาษาอังกฤษ 1 ชุดและวิธีการใช้งานภาษาไทยอย่างละ 1 ชุด

5. การทดสอบและผล

5.1 ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ 2, 3 และ 4

5.2 ทำการทดสอบความสามารถใช้งานได้ดี



6. ข้อกำหนดอื่นๆ

พ.ต.อ. หญิง..... ผู้อำนวยการ นิตยสารนักงานกรรมการ
(สุวรรณ ชาญฤทธิ์)

พ.ต.อ. หญิง..... กรรมการ
(สุชาดา คำเจียรา)

พ.ต.อ. หญิง..... กรรมการ
(วิรักรอง รัตนสุวรรณ)

รพ.ตร. อุบมิติ ลงวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๕

6.1 รับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี และจะต้องมีอะไหล่ไว้ให้บริการตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

6.2 ในระหว่างการรับประกันผู้ขายต้องส่งเจ้าหน้าที่ช่าง มาทำการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องและบำรุงรักษาอย่างน้อยทุก ๓ เดือน พร้อมมีเอกสารแสดงวิธีการตรวจสอบและบำรุงรักษาให้หน่วยงานที่ใช้ทุกครั้ง หากในระหว่างการตรวจสอบและการบำรุงรักษาพบว่า มีอุปกรณ์ใดชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ต้องแจ้งให้หน่วยงานที่ใช้ทราบ ดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย


6.3 มอเตอร์ไฟฟ้าต้องได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน IECEE และ CB Test Certificate รับประกันมอเตอร์ไฟฟ้า ๕ ปี รับประกันแบตเตอรี่ ๒ ปี


6.4 ผู้ขายต้องได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตสินค้าขึ้นห้องน้ำโดยตรงหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยมีหนังสือรับรองน้ำยืนยันในวันพิจารณา

6.5 สินค้าที่เสนอได้รับการรับรองจากองค์กรอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขแล้วว่าขึ้นบัญชีการนำเข้าเพื่อจำหน่ายเป็นเครื่องมือแพทย์อย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยมีเอกสารยืนยันในวันพิจารณา

6.6 มีช่างที่ได้รับการฝึกอบรมจากโรงงานผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยมีหนังสือรับรองยืนยัน

พ.ต.อ. หญิง  ประธานกรรมการ
(สุวรรณ ชาลุสกุล)

 กรรมการ
(สุชาดา คำเมี่ยง)

พ.ต.อ. หญิง  กรรมการ
(วิรักรอง รัตนสุวรรณ)

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแผนกสังเคราะห์ฯ กำหนดลักษณะเฉพาะโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่
ได้มีมติเห็นชอบในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่เสนอในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พ.ต.อ. หญิง  ประธานกรรมการ
(สุวรรณ ชาลุสกุล)

แบบอุดมทรัพย์/กรรมการและเลขานุการฯ
เห็นชอบ
พ.ต.อ. หญิง  ประธานกรรมการ
(สุวรรณ ชาลุสกุล)

พยาบาล (๘๙๕) หน.กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.