


- 3.1.14 ปรับทำยกเข้า ด้วยระบบผ่อนแรงได้ไม่น้อยกว่า 45 องศา เมื่อวัดจากส่วนรองรับต้นขาทำมุมกับแนวราบ
- 3.1.15 ปรับทำศีรษะต่ำ ด้วยระบบผ่อนแรง ได้ไม่น้อยกว่า 12 องศา จากแนวราบ
- 3.1.16 ปรับทำศีรษะสูง ด้วยระบบผ่อนแรง ได้ไม่น้อยกว่า 12 องศา จากแนวราบ
- 3.2 ราวกันเตียง มีคุณสมบัติดังนี้
 - 3.2.1 ทำจากโลหะเคลือบสีกันสนิม
 - 3.2.2 มีความสูงวัดจากพื้นเตียง (ไม่รวมความหนาของเบาะ) ถึงส่วนบนสุดของราวกันไม่น้อยกว่า 350 มิลลิเมตรเมื่อตั้งราวกันเตียงขึ้น
- 3.3 เบาะที่นอน มีคุณสมบัติดังนี้
 - 3.3.1 มีความกว้างอยู่ในช่วง 700 ถึง 900 มิลลิเมตร และมีขนาดความยาวอยู่ในช่วง 2,000 ถึง 2,200 มิลลิเมตร
 - 3.3.2 วัสดุหุ้มเบาะที่นอนทำจากโพลียูรีเทน มีคุณสมบัติทนทานต่อสารทำความสะอาดและสามารถป้องกันน้ำซึมผ่านได้
 - 3.3.3 เบาะที่นอนทำจากโฟม (Foam) มีคุณสมบัติให้แสงเอ็กซเรย์ (X-ray) ผ่านได้
- 3.4 ล้อ มีคุณสมบัติดังนี้
 - 3.4.1 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ทำจากโพลียูรีเทน
 - 3.4.2 สามารถลื้อคล้อทั้งหมดได้จากแป้นเหยียบของล้อเตียงล้อใดล้อหนึ่งเพียงล้อเดียว
- 4. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่
 - 4.1 เสาค้ำสำหรับเขวมน้ำเกลือแบบเก็บได้ทำจากเหล็กไม่เป็นสนิม (Stainless steel) และผลิตจากผู้ผลิตเดียวกันกับเตียง จำนวน 1 ต้น
 - 4.2 คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด
- 5. การทดสอบและผล
 - 5.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อ 2, 3 และ 4
 - 5.2 ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้
- 6. ข้อกำหนดอื่นๆ
 - 6.1 รับประกันคุณภาพพร้อมทั้งความชำรุดบกพร่อง ตามสภาพใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งมอบสินค้า โดยจะต้องมีอะไหล่ไว้พร้อมบริการให้ตลอดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 - 6.2 ในระหว่างรับประกันหากพบว่าเตียงหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเตียงไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติที่ควรจะเป็น ผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ที่ได้แจ้งให้ทราบ และผู้ขายจะต้องนำเตียงสำรองมาให้ใช้ในระหว่างทำการแก้ไขนั้น หากมีการแก้ไข 3 ครั้งแล้วยังใช้งานได้ไม่ดีตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำเตียงใหม่ซึ่งไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและสามารถใช้งานได้ดีตามปกติมาเปลี่ยนให้ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่แจ้งให้แก้ไขครั้งที่ 3 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นและเตียงใหม่นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันแบบเดิมเช่นเดียวกับการรับเตียงใหม่ทุกประการ

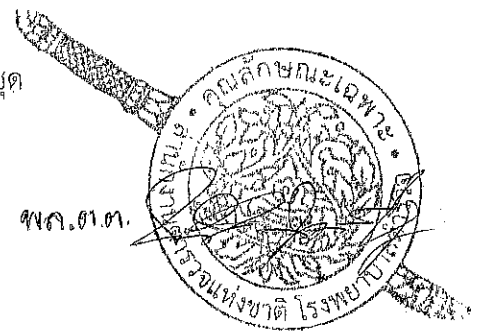

พ.ต.ท.หญิง ประธานกรรมการ ร.ต.อ.หญิง กรรมการ ร.ต.ต.หญิง กรรมการ
 (ส.ศ.ส.ว. ดีโรส) (ก.พ.ค.ว.จ. อดิเรก) (ข.น.ก.ช.ท. บ.ค.ช.ช.ง)

- 6.3 ผู้ขายต้องเป็นผู้ผลิตหรือมีเอกสารรับรองให้เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตให้จัดจำหน่ายสินค้านี้ในประเทศไทย
- 6.4 ในระหว่างรับประกันผู้ขายจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและบำรุงรักษาทุก 6 เดือน พร้อมมีเอกสารแสดงการตรวจสอบ และแจ้งผลการบำรุงรักษาให้กับหน่วยงานเจ้าของเตียงทุกครั้ง

พ.ต.ท.หญิง..... *NT*ประธานกรรมการ

(*สีกัญญา ตีโรภัก*)

ร.ต.อ.หญิง *กฤษณา โขนกน*กรรมการ


(*กฤษณา โขนกน*)

ร.ต.ต.หญิง *สุนิษา บุษยาน*กรรมการ

(*สุนิษา บุษยาน*)

เห็นชอบ
[Signature]
พ.ต.อ.....
(*เสรี อีรพงษ์*)

นายแพทย์ (สบ5) หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร.

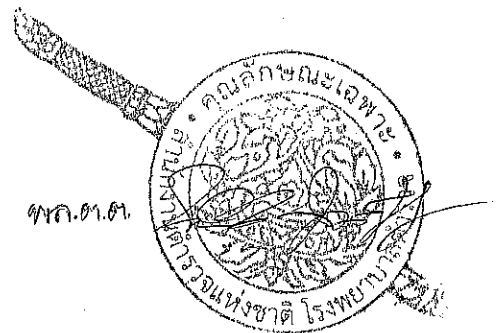

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รพ.ตร.

ได้มีมติเห็นชอบตามคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่เสนอในคราวประชุม

ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๘

พ.ล.ต.ต.

[Signature]

(*ชินนทร์ สุดโนริกุล*)

ผบก.อก.รพ.ตร. /

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ