

เลขที่ 3-57

รพ.ตร. อนุมัติ ลงวันที่ 28 ม.ค. 57

คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ชนิดไม่สัมผัสโลหิต

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้วัดความดันโลหิตผู้ป่วยโดยไม่ต้องสัมผัสโลหิต เพื่อคัดกรองคนไข้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคต่อหิน

๒. ลักษณะทั่วไป

๒.๑ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ชนิดไม่สัมผัสโลหิต

๒.๒ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับขนาด ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ มีระบบ APC (Auto Puff Control) ปรับความดันแรงลมอัตโนมัติ เพื่อให้ลมที่พ่นออกมา มีความนุ่มนวลขึ้นต่อดวงตาของคนไข้

๓.๒ สามารถวัดความดันโลหิต สูงสุดได้อย่างน้อย ๒ ระดับ ที่ ๔๐ และ ๖๐ มิลลิเมตรปรอท

๓.๓ ระยะเวลาในการทำงานไม่น้อยกว่า ๑๑ มิลลิเมตร

๓.๔ มีไฟล่อให้คนไข้มองจากภายใน (Inner fixation light)

๓.๕ มีระบบการติดตามตา ๑ มิติ

๓.๖ มีระบบการปล่อยลมแบบอัตโนมัติ


๓.๗ มีจอภาพแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว

๓.๘ มีระบบพิมพ์ผลภายในตัวเครื่อง

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

๔.๑ หนังสือคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๔.๒ โด๊ะไฟฟ้าสามารถปรับระดับได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

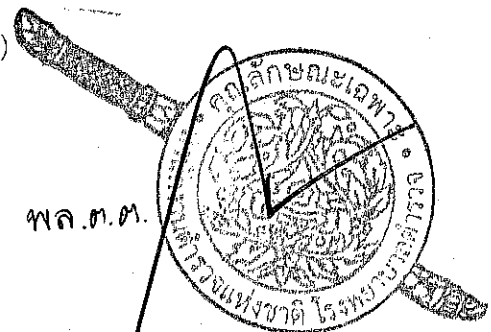

อย่างละ ๑ ชุด

จำนวน ๑ ตัว

พ.ต.อ. .... ประธานกรรมการ พ.ต.ต.หญิง ..... กรรมการ ว่าที่ร.ต.อ.หญิง ..... กรรมการ

(เชาวรัช สมแก้ว)

(สุชยา ก่อวนิช)

(สุรางคณา ตรงธรรม)


๕. การทดสอบและผล


- ๕.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อย ตามข้อ ๒, ๓ และข้อ ๔
- ๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี


เลขที่ 3-57  
 รพ.ตร. อนุมัติ ลงวันที่ 28 ม.ค. 57

๖. ข้อกำหนดอื่น ๆ


- ๖.๑ รับประกันคุณภาพพร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี และจะต้องมีอะไหล่ไว้พร้อมบริการตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๖.๒ มีการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือให้เจ้าหน้าที่จนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ คน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง หรือจนกว่าใช้งานได้ดี

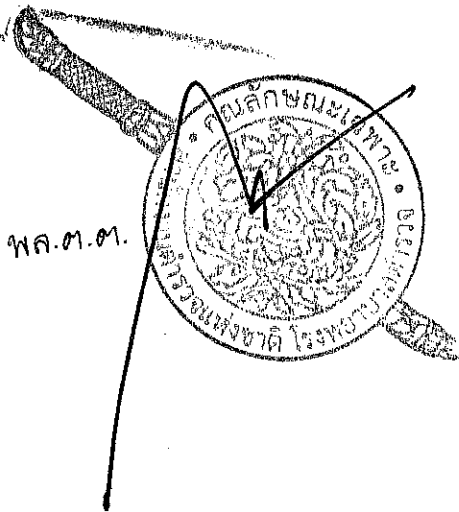


พ.ต.อ.  ประธานกรรมการ  
 (เชาวรัช สมแก้ว)  
 นพ.(สบ ๕) หน.กลุ่มงานตา รพ.ตร


พ.ต.ต.หญิง  กรรมการ  
 (สุชยา ก่อวนิช)  
 นพ.(สบ ๒) กลุ่มงานตา รพ.ตร

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะโรงพยาบาลตา  
 ได้มีมติเห็นชอบตามคุณสมบัติเฉพาะฯ ที่เสนอในคราวประชุม  
 ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๖  
 พล.ต.ต.

 (สมศักดิ์ จิตติรัตน์)  
 ผบก.อก.รพ.ตร./กรรมการและเลขานุการฯ

-เห็นชอบ

พ.ต.อ.   
 (เชาวรัช สมแก้ว)  
 นพ.(สบ ๕) หน.กลุ่มงานตา รพ.ตร

พ.ต.อ.หญิง  กรรมการ  
 (สุรางคณา ตรงธรรม)  
 น.พ.(สบ ๑) กลุ่มงานตา รพ.ตร.