

คุณลักษณะเฉพาะ

ชุดใส่ท่อช่วยหายใจ

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ส่องตรวจกล่องเสียงเพื่อทำการใส่ท่อช่วยหายใจ

2. ลักษณะทั่วไป

ประกอบด้วย

2.1 ด้ามจับ (Handles)

2.2 แผ่นสำหรับส่องตรวจ (BLADE)

2.3 แท่นชาร์จ

3. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

3.1 ด้ามจับ (Handles)

3.1.1 ด้ามจับทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม(STAINLESS STEEL) หรือเหล็กชุบโครเมียม

3.1.2 หลอดไฟเป็นหลอด LED 3.5 V ให้แสงสีขาวสว่าง ไม่ร้อน

3.1.3 ด้ามจับสามารถใช้กับถ่านที่ชาร์จไฟได้หรือใช้กับถ่านไฟฉายขนาดกลาง (SIZE C) 2 ก้อนได้

3.2 แผ่นสำหรับส่องตรวจ (BLADE)

3.2.1 แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 2 ความยาวไม่น้อยกว่า 115 มิลลิเมตร จำนวน 1 อัน

3.2.2 แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 3 ความยาวไม่น้อยกว่า 135 มิลลิเมตร จำนวน 1 อัน

3.2.3 แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 4 ความยาวไม่น้อยกว่า 155 มิลลิเมตร จำนวน 1 อัน

3.2.4 แผ่นสำหรับส่องตรวจส่องตรวจ ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม (STAINLESS STEEL)


3.2.5 เมื่อประกอบแผ่นส่องตรวจเสียบต่อกับด้ามจับจะเกิดแสงไฟที่หลอดไฟ LED

3.2.6 แผ่นส่องตรวจมีท่อนำแสงเป็นระบบ (FIBER OPTIC) เป็นแบบท่อหุ้มท่อนำแสงเพื่อป้องกันความเสียหาย

และทำความสะอาดง่าย

3.3 แท่นชาร์จ

แท่นชาร์จ สามารถใช้ได้ทั้งด้ามกลางและด้ามเล็กมีไฟแสดงสถานะ การชาร์จ และ ไฟแสดงสถานะ ประจุเต็ม

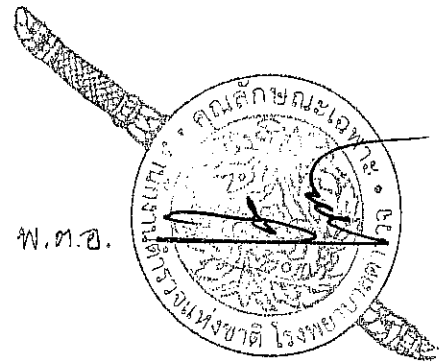

พ.ต.ช.

พ.ต.อ.หญิง.....ประธานกรรมการ
(อัยยา รุ่งอุทัย)

พ.ต.ท.หญิง.....กรรมการ
(อำภพร คงคาชนะ)

พ.ต.ท.หญิง.....กรรมการ
(นวรรตน์ ศรีรัฐเพชร)

4. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่


- 4.1 ก่องใส่ชุดใส่ท่อช่วยหายใจ ออกแบบโดยเฉพาะ 1 ใบ
4.2 ถ่านชาร์จไฟได้ จำนวน 1 ก้อน
4.3 หนังสือคู่มือการใช้งานภาษาไทย จำนวน 1 ชุด

5. การทดสอบและผล

- 5.1 ตรวจสอบพินิจความเรียบร้อยตามข้อ 2,3 และข้อ 4
5.2 ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

6. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 6.1 ผู้ขายต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
6.2 รับประกันคุณภาพพร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
โดยจำต้องมีอะไหล่ไว้พร้อมให้บริการตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

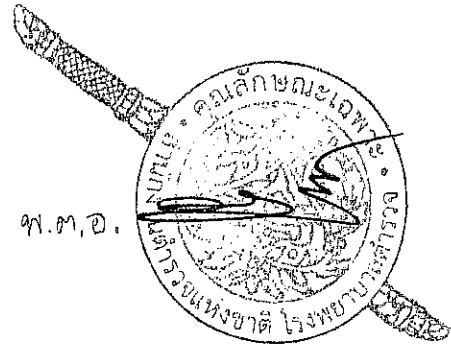

พ.ต.อ.หญิง...ประธานกรรมการ
(อัยยา รุ่งอุทัย)

พยาบาล (สบ4) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

พ.ต.ท.หญิง...กรรมการ
(อำภพร คงคาชนะ)

พยาบาล (สบ3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

พ.ต.ท.หญิง...กรรมการ
(นวรรตน์ ศรีรัฐเพชร)

พยาบาล (สบ3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รพ.ตร.

ได้มีมติเห็นชอบตามคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่เสนอในคราวประชุม

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๗

เห็นชอบ

พ.ต.อ.

(เกษม รัตนสุมาวงศ์)

นายแพทย์ (สบ5) หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.

พ.ต.อ.

(สุริยะ อยู่เย็น)

รอง ผบก.ฯ พรท. ผบก.อ.รพ.ตร. /

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ